Miroir Photo

Mode d'emploi

En achetant ces miroirs pour la photographie, vous disposez d'un produit de grande qualité qui a été développé en étroite collaboration avec des instituts professionnels et qui s'est établi sur le marché mondial depuis plus de 35 ans.
La couche réfléchissante très dure et résistante aux rayures garantit

- Réflexion élevée
- Bonne neutralité des couleurs
- Pas de double image

La poignée de maintien coudée permet de tenir le miroir sans affecter la surface du miroir.

Lisez attentivement le présent mode d'emploi et conservez-le dans un endroit approprié. Le strict respect de nos instructions garantit une utilisation sûre et sans danger de notre produit ainsi qu'une durée de vie la plus longue possible.

Matériaux:
Le miroir est composé d'un verre métallisé au rhodium qui est collé manuellement sur la poignée de maintien. La poignée de maintien est une fonte d'aluminium recouverte d'un polyester de silicone. L'adhésif utilisé est une résine mono-composant durcissant en l'absence d'air et aux rayons UV, sans solvant.

Domaine de validité:
Le mode d'emploi est valable pour les miroirs suivants destinés à la photographie :

- Types A, B1, B2 & C, pour prises d'empreintes occlusales
- Type D, pour les prises de vue latérales
- Type S, kit de miroirs
- Type O, pour les prises d'empreintes occlusales sans manche
- Type L, pour l'imagerie linguale sans manche

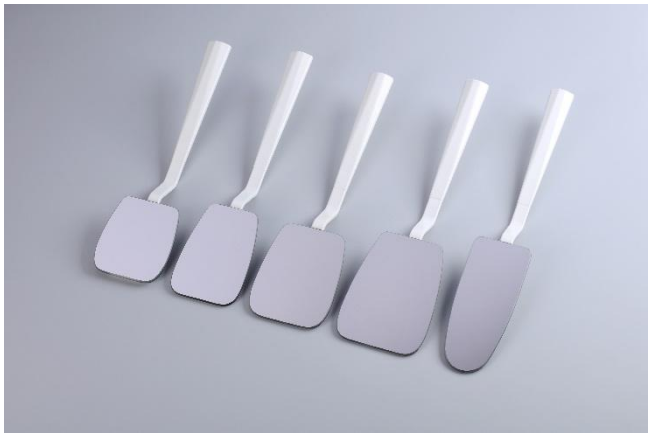

Miroirs petit, moyen, grand et latéral

Manipulation et déploiement sécurisés:

- Utilisation et préparation uniquement par du personnel formé
- N'utiliser les miroirs que conformément aux prescriptions sans quoi ils pourraient s'endommager ou se casser
- Nettoyer, désinfecter et/ou stériliser le produit avant la première utilisation
- Entreposer les produits de manière à ce qu'ils ne s'endommagent pas
- Ne pas utiliser de produits endommagés Mettre immédiatement au rebut les produits endommagés

Instructions de préparation:

- La colle anaérobie utilisée étant un acrylate, elle ne résiste pas durablement aux solvants ; l'action des produits de nettoyage et de désinfection peut endommager le joint de colle et les liquides peuvent s'infiltrer dans le joint de colle. C'est pourquoi les miroirs ne doivent pas être insérés.
  Le fabricant n'assume aucune garantie à cet égard.
- Les directives internationales et nationales, les normes et les prescriptions légales ainsi que les propres règles d'hygiène en matière de préparation doivent être respectées.
- Pour les personnes souffrant de maladies infectieuses, respecter les directives correspondantes.

Restrictions concernant la préparation:
Lors de la préparation, la plus grande prudence est de mise en raison de la minceur du revêtement des miroirs et des poignées de maintien peintes. Une préparation fréquente mais conforme aux instructions n'a que peu d'effet sur la qualité et la durée de vie des miroirs.
La fin de vie du produit est normalement déterminée par l'usure due à l'utilisation. Les miroirs doivent alors être éliminés comme il est d'usage dans les cabinets dentaires.

Nettoyage mécanique:
Après utilisation, les miroirs peuvent être

- rincés à l'eau courante afin d'éliminer les grosses impuretés et les résidus de salive
- essuyés à l'aide d'un chiffon doux afin d'éliminer en douceur les particules résiduelles sur la surface, en particulier sur le verre du miroir et sur les bords

FILTROP AG
Landstrasse 16
9496 Balzers | Liechtenstein
Téléphone +423 388 11 50
info@filtrop.com
www.filtrop.com

REV04, Date d'émission: 14.03.2025, Balzers, Liechtenstein
Basis UDI-DI: 426071006MSP2

Désinfection:
Après utilisation, les miroirs peuvent
- être nettoyés manuellement au moyen d'un chiffon désinfectant
- être plongés brièvement dans une solution de nettoyage ou de désinfection douce adaptée aux instruments

La solution de nettoyage et de désinfection doit être adaptée au nettoyage manuel (non moussante, etc.).
Elle doit être changée selon les indications du fabricant ou en cas de salissures visibles.

Le nettoyage par ultrasons n'est pas recommandé.

D'une manière générale, nettoyer et désinfecter les miroirs conformément aux recommandations de l'Institut Robert Koch.

Neutralisation / rinçage:
Rincer les miroirs nettoyés ou désinfectés à l'eau claire ou stérile selon la procédure habituelle du cabinet afin d'éliminer tous les résidus de produit nettoyant et de désinfectant.

Stérilisation:
Les miroirs peuvent être stérilisés, par exemple en autoclave.
Éviter cependant les liquides de stérilisation qui contiennent des produits chimiques agressifs, comme l'hypochlorite.
En cas de stérilisation fréquente, il faut s'attendre à des altérations (par exemple, un décollement partiel de la peinture sur la poignée de maintien).
Méthode de stérilisation recommandée :
En autoclave (DIN EN ISO 17665-1)
Température recommandée: 121 °C (134 °C)
Pression recommandée: 2 bars (3 bars)
Durée de rétention: ≥ 20 min (≥ 5 min)

Sécher et stocker:
Après la neutralisation laisser sécher les miroirs sur un chiffon propre à l'air libre à température ambiante ou les sécher à l'air comprimé.
Conserver le miroir séché dans son emballage d'origine propre et fermé, afin d'éviter toute nouvelle contamination.

Contrôle du fonctionnement:
Vérifiez le bon fonctionnement des miroirs avant chaque utilisation. Les miroirs dont les surfaces en verre et les revêtements sont endommagés (rayures, éclats, fissures, etc.) ne doivent plus être utilisés. Les miroirs doivent alors être éliminés conformément aux pratiques habituelles.

Risques:
Les risques suivants peuvent survenir:
- Coupures en cas de miroir endommagé ou de personnes souffrant de convulsions dues à des éclats ou des arêtes vives
- Réactions allergiques:
  - à l'aluminium, en cas de poignées endommagées
  - à la colle, en cas de préparation non conforme

Restriction d'utilisation:
Chez les personnes sujettes aux convulsions, les miroirs ne doivent être utilisés qu'avec des barrières de mâchoire.
Pour les personnes souffrant de maladies infectieuses, l'utilisation de miroirs avec poignée est déconseillée. Nous conseillons plutôt d'utiliser des miroirs sans poignées. La préparation des miroirs sans poignée doit en tout état de cause être effectuée avec soin et conformément aux normes:

Miroir sans poignée pour prises de vue occlusales et linguales

Garantie:
Les miroirs sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et soumis à un contrôle de qualité avant leur livraison. Nous ne garantissons pas l'adéquation à l'intervention en question. C'est à l'utilisateur de le déterminer lui-même.
Nous n'assumons pas non plus de responsabilité pour les dommages accidentels ou résultant de l'utilisation.
Nous n'assumons aucune responsabilité s'il est prouvé que le présent mode d'emploi n'a pas été respecté notamment en cas de mauvaise manipulation du nettoyage ou de la désinfection.

FILTROP AG
Landstrasse 16
9496 Balzers | Liechtenstein
Téléphone +423 388 11 50
info@filtrop.com
www.filtrop.com

REV04, Date d'émission: 14.03.2025, Balzers, Liechtenstein
Basis UDI-DI: 426071006MSP2